


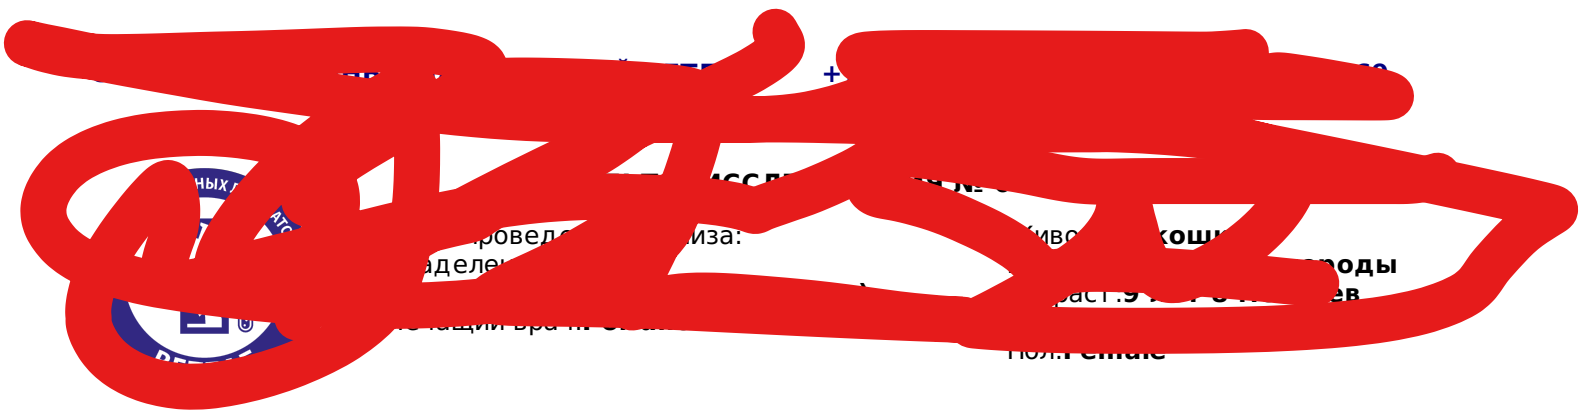

Общий клинический анализ крови полный + Ретикулоциты

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	5,4	тыс/мкл	5,5 - 18,5	▼2%
Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов	0		0 - 5	норма
Скорректированное количество лейкоцитов	5,40	$\times 10^9/\text{л}$	5,50 - 18,50	▼2%
Эритроциты (RBC)	11,27	млн/мкл	5,60 - 10,00	▲13%
Гемоглобин (HGB)	160	г/л	90 - 150	▲7%
Гематокрит (HCT)	46,0	%	29,0 - 48,0	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	40,82	$\text{мкм}^3(\text{фл})$	39,00 - 53,00	норма
Среднее содержание НЬ в эритроците (MCH)	14,20	Пг	14,00 - 19,00	норма
Средняя концентрация НЬ в эритроците (MCHC)	348	г/д	320 - 360	норма
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	16,60	%	14,00 - 18,00	норма
Тромбоциты (PLT)	243	тыс/мкл	160 - 630	норма
Нейтрофильные миелоциты	0	%	0	норма
Нейтрофильные метамиелоциты	0	%	0	норма
Палочкоядерные нейтрофилы	0	%	0 - 3	норма
Сегментоядерные нейтрофилы	53	%	35 - 75	норма
Эозинофилы	3	%	0 - 6	норма
Моноциты	2	%	0 - 4	норма
Базофилы	0	%	0 - 1	норма
Лимфоциты	42	%	25 - 55	норма
Другое	0	%	0,00	норма

Абсолютные значения лейкоцитов

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	0	$\times 10^9/\text{L}$	0,000 - 0,550	норма
Сегментоядерные нейтрофилы	2,862	$\times 10^9/\text{L}$	1,900 - 13,900	норма
Эозинофилы	0,162	$\times 10^9/\text{L}$	0,000 - 1,100	норма
Моноциты	0,108	$\times 10^9/\text{L}$	0,000 - 0,740	норма
Базофилы	0	$\times 10^9/\text{L}$	0,000 - 0,160	норма
Лимфоциты	2,268	$\times 10^9/\text{L}$	1,400 - 10,200	норма

Ретикулоциты (У кошек пунктатные и агрегатные ретикулоциты. У собак только агрегатные ретикулоциты.)

Ретикулоциты кошки

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Абсолютное значение ретикулоцитов	13,50	10 ⁹ /L	4,00 - 52,00	норма
Относительное значение ретикулоцитов	0,12	%	0,05 - 0,90	норма
Ретикулоциты агрегатные	7,10	%	0,00 - 33,00	норма
Ретикулоциты пунктатные	92,90	%	66,00 - 100,00	норма
Абсолютные значения пунктатных ретикулоцитов	-	10 ⁹ /L	2,640 - 52,000	▼100%

Исследование провел: Неретина Е.В.

Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

